

# HOJA DE MEDIDAS

Sedestación

## Asiento postural *Gepetto Mousse CAD-CAM*



Parque Tecnológico de Asturias – Parcela 1  
33428 – Llanera – Principado de Asturias  
T:+34 985 79 48 00 F:+34 985 79 48 10

### DATOS DEL PACIENTE

Nombre: \_\_\_\_\_ Edad: \_\_\_\_\_  
Apellidos: \_\_\_\_\_

### MATERIAL DE FRESADO / COMBO

|                          |          |                          |                         |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Blanca   | <input type="checkbox"/> | Combo T/S (60x50x36 cm) |
| <input type="checkbox"/> | Amarilla | <input type="checkbox"/> | Combo T/M (70x60x42 cm) |
| <input type="checkbox"/> | Gris     | <input type="checkbox"/> | Combo T/L (70x60x50 cm) |

### ORTOPEDIA

Nombre: \_\_\_\_\_  
Técnico: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_


### FUNDA TEXTIL *Gepetto Tex*

|                          |             |   |
|--------------------------|-------------|---|
| <input type="checkbox"/> | No          | <input type="checkbox"/> Rojo<br><input type="checkbox"/> Pistacho<br><input type="checkbox"/> Gris<br><input type="checkbox"/> Negro |
| <input type="checkbox"/> | Sí          |   |
| <input type="checkbox"/> | Unds. _____ |   |

### CARCASA *Gepetto Box*

|                          |    |   |                          |      |                          |       |                          |       |
|--------------------------|----|---|--------------------------|------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> Naturplast<br><input type="checkbox"/> ABS | <input type="checkbox"/> | 8 mm | <input type="checkbox"/> | 10 mm | <input type="checkbox"/> | 12 mm |
| <input type="checkbox"/> | Sí |   | <input type="checkbox"/> | 4 mm | <input type="checkbox"/> | 5 mm  |                          |       |

Pintado de espuma  Pruviatex Black impermeable

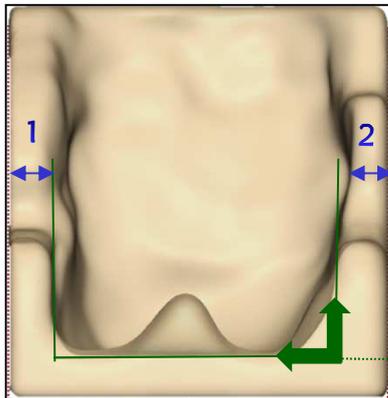



Grosor mínimo:  
1- Lado dcho. \_\_\_\_\_ mm.  
2- Lado izdo. \_\_\_\_\_ mm.  
3- En respaldo \_\_\_\_\_ mm.  
4- En asiento \_\_\_\_\_ mm.

Basculación pélvica  
° sobre molde


(( ))  
AMPLITUD INTERNA:  
\_\_\_\_\_ mm

Inclinación respaldo  
° sobre molde

Basculación total  
° sobre molde

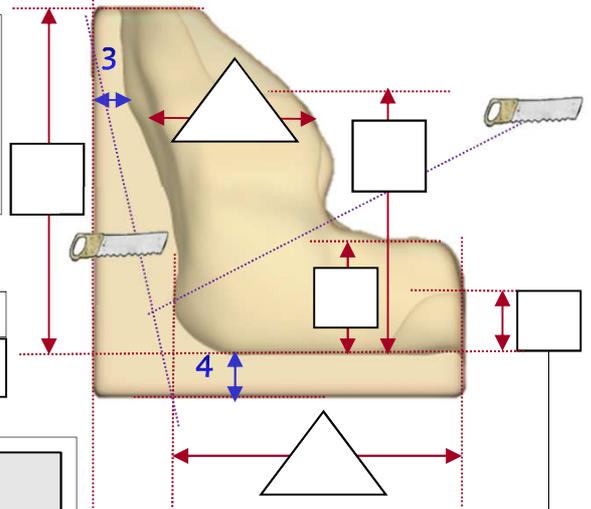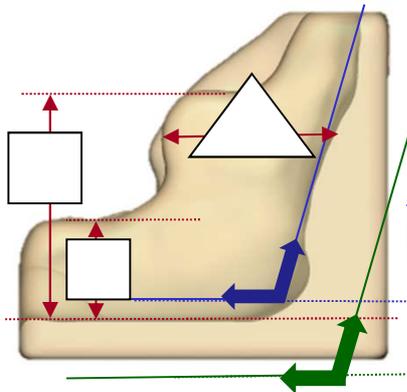

Taco Abductor  
 No  Sí



Es imprescindible adjuntar a esta hoja el molde de escayola o un archivo de escáner y cubrir todos los campos de medidas, así como una foto frontal del paciente sobre el calergo. Se recomienda adjuntar un croquis sobre el diseño del asiento a esta hoja de medidas.